


CT装置別の成人CTにおけるCTDI_{vol}値のDRLs比

■ RevolutionCT ■ RevolutionEVO

集計期間：2021/1/1～2021/11/30

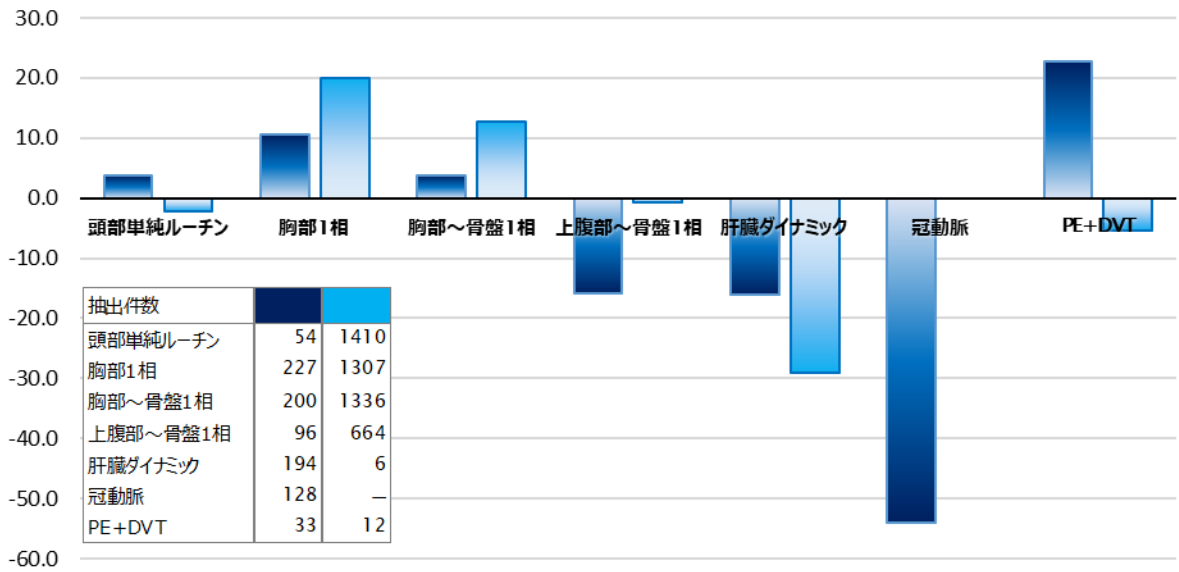


	頭部	胸部	胸部～骨盤	上腹部～骨盤	肝臓	冠動脈	PE+DVT
DRLs2020	77	13	16	18	17	66	14
RevolutionCT	79.8	14.4	16.6	15.1	14.3	30.4	17.2
RevolutionEVO	75.4	15.6	18.1	17.9	12.1	—	13.2

[mGy]

CT装置別の成人CTにおけるDLP値のDRLs比

■ RevolutionCT ■ RevolutionEVO

集計期間：2021/1/1～2021/11/30

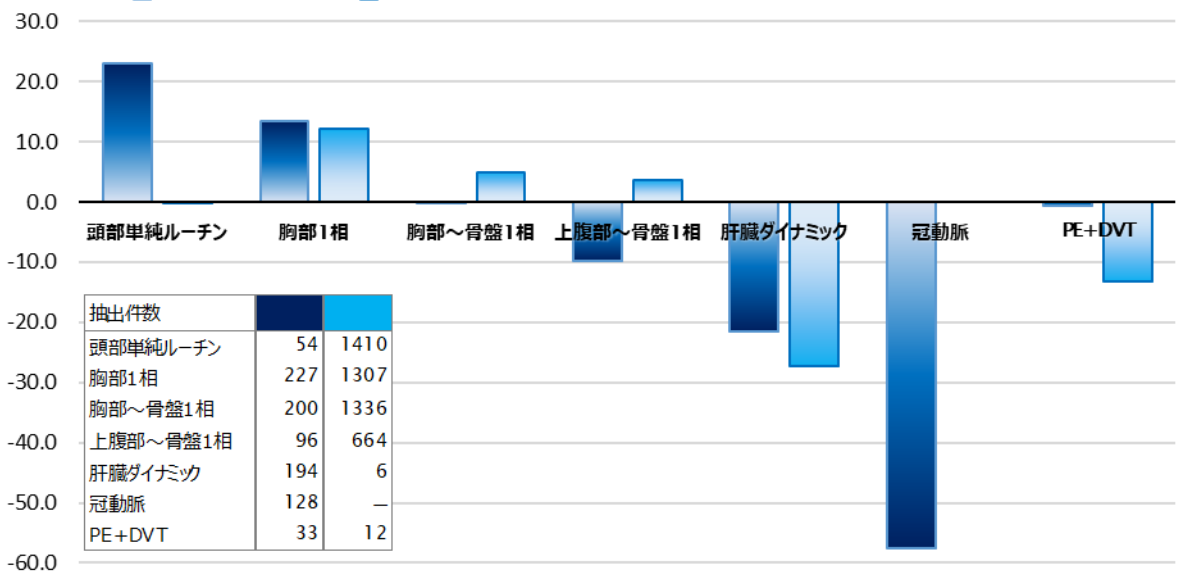


	頭部	胸部	胸部～骨盤	上腹部～骨盤	肝臓	冠動脈	PE+DVT
DRLs2020	1350	510	1200	880	2100	1300	2600
RevolutionCT	1661.1	578.8	1197.1	793.3	1649.4	552.0	2585.6
RevolutionEVO	1347.2	572.4	1258.1	912.5	1527.8	—	2255.7

[mGy・cm]

小児頭部CTにおける線量値のDRLs比（RevolutionEVO）

集計期間：2021/1/1～2021/11/30

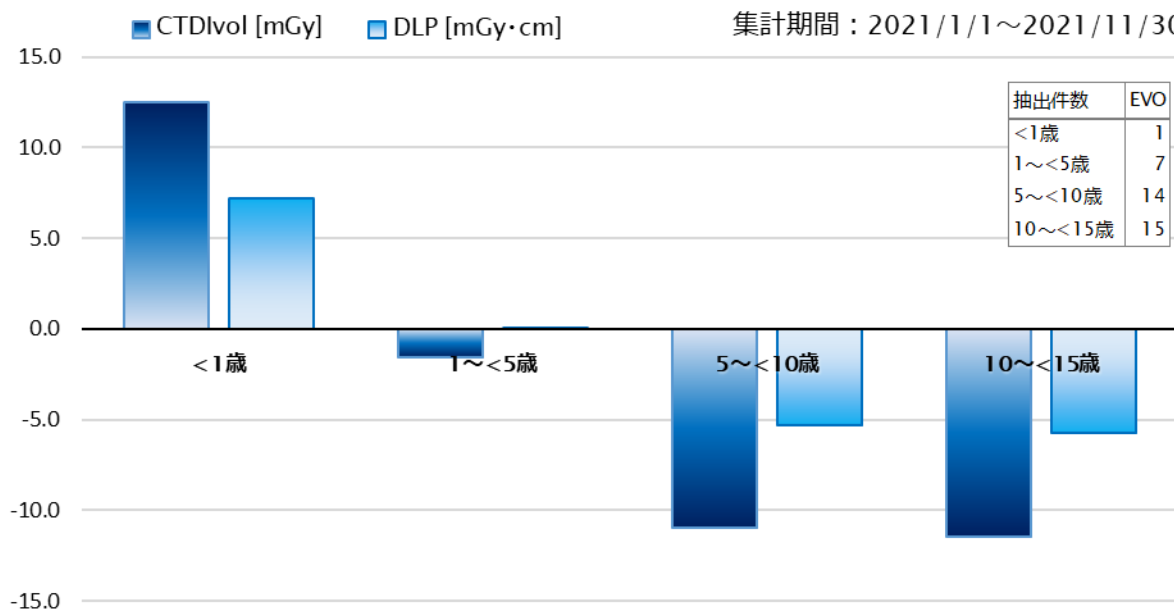

CTDIvol [mGy]	<1歳	1～<5歳	5～<10歳	10～<15歳
DRLs2020	30	40	55	60
RevolutionEVO	33.8	39.4	49.0	53.1

DLP [mGy·cm]	<1歳	1～<5歳	5～<10歳	10～<15歳
DRLs2020	480	660	850	1000
RevolutionEVO	514.5	660.3	805.0	942.4