


X線CT装置 線量(CTDI_{vol})測定結果推移

実測基準比推移 (頭部用16cm)



実測基準比推移 (腹部用32cm)

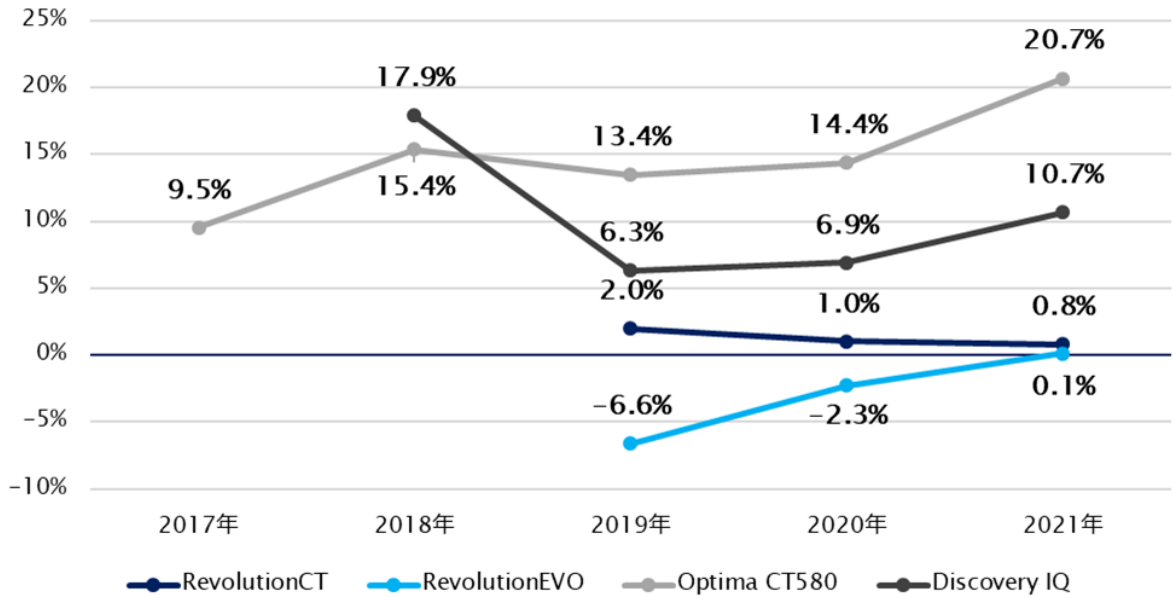