

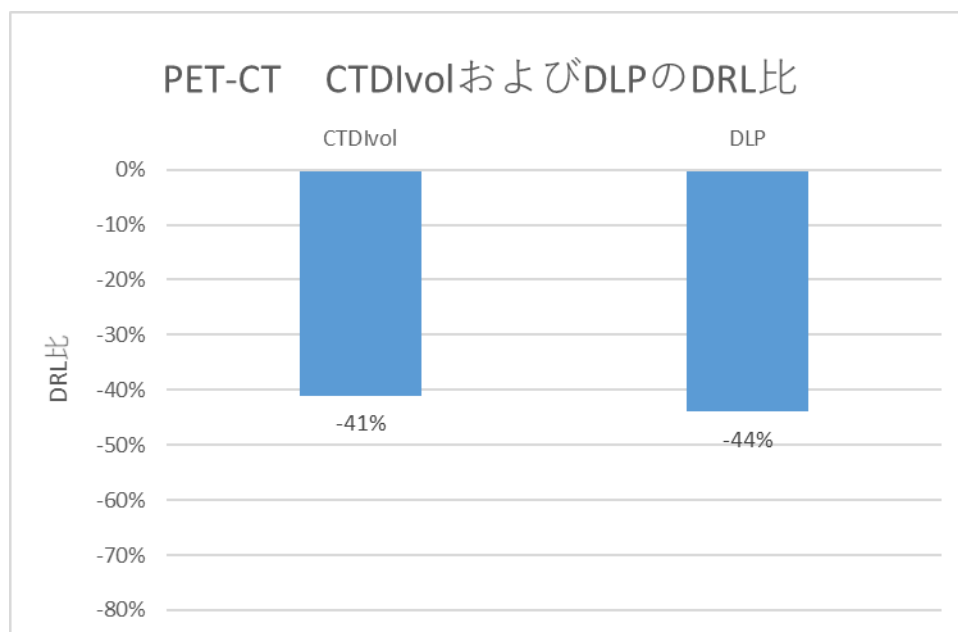


表1. PET-CT における CTDIvol および DLP の中央値

	CTDIvol[mGy]	DLP[mGy・cm]
DRLs2020	6.1	600
Discovery IQ	3.6	335.6
集計件数	100	100

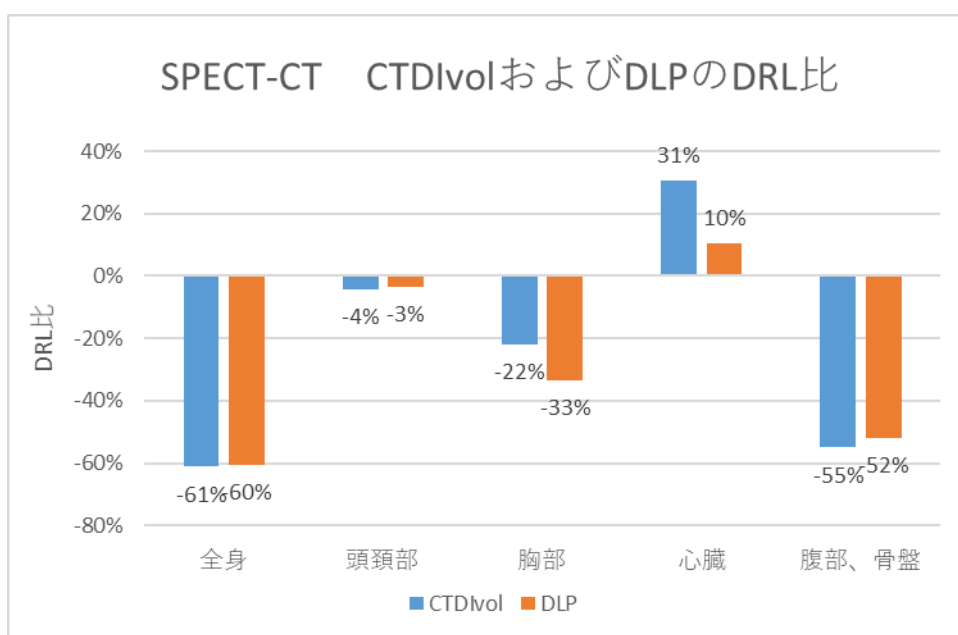


表2. SPECT-CT における CTDIvol および DLP の中央値

撮影範囲	全身		頭頸部		胸部		心臓		腹部、骨盤部	
	CTDIvol[mGy]	DLP[mGy・cm]	CTDIvol[mGy]	DLP[mGy・cm]	CTDIvol[mGy]	DLP[mGy・cm]	CTDIvol[mGy]	DLP[mGy・cm]	CTDIvol[mGy]	DLP[mGy・cm]
DRLs2020	5	380	5.8	210	4.1	170	4.5	180	5	210
SymbiaT	1.94	150.4	5.27	187.7	3.08	110.7	5.89	222.1	2.2	88.4
集計件数	80		28		94		36		7	